


お客様各位

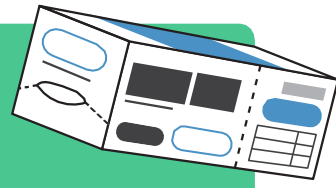


# 「電子化された添付文書」 のご案内

2021年8月1日から、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（以下「薬機法」）の改正によって、医療機器の添付文書は**電子化された添付文書での閲覧が基本**となります※。

専用のアプリケーション（専用アプリ）で容器又は被包のGS1コードを読み取ることで、スマートフォンやタブレット端末でPMDAホームページ上の最新の電子化された添付文書や関連情報をいつでもご覧いただけるようになります。

なお、2021年8月1日から2023年7月31日までの期間に順次、製品への添付文書の同梱は終了する予定です。

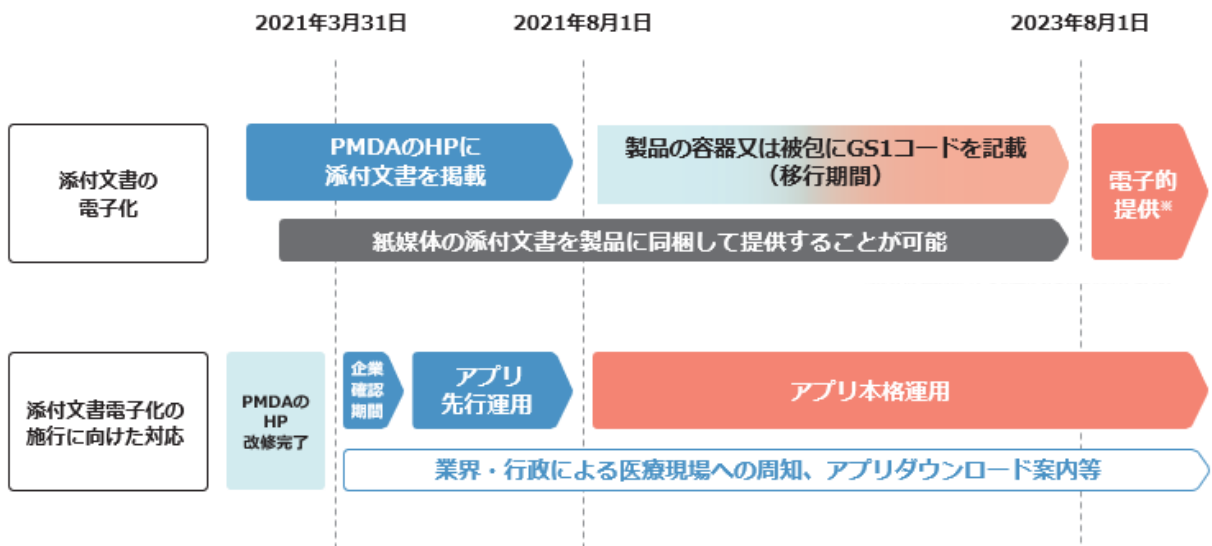



# 電子化された添付文書を閲覧する

## → 専用アプリ「添文ナビ」を利用する

### STEP 1

#### 専用アプリをインストールする




#### 電子添文閲覧アプリ「添文ナビ」

ダウンロードはこちらから



### STEP 2

#### 容器又は被包のGS1コードをアプリで読み取る

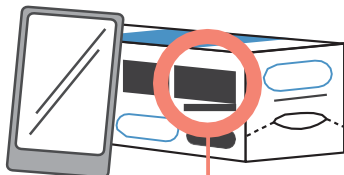

GS1コードのサンプル


GS1-128シンボル

(01) 04912345123459  
GS1データバー

GS1データマトリックス


### STEP 3

#### 閲覧したい情報を選ぶ

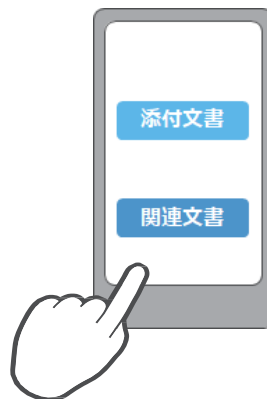

## 専用アプリで閲覧できる文書

専用アプリの該当するボタンを選択すると、電子化された添付文書や各種関連文書を閲覧することができます。

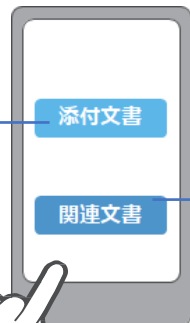

一般的名称	●●●●●
販売名	ディスプレイザル パビロトーム V-System
製造販売業者等	製造販売 / ●●●株式会社
添付文書	HTML PDF(2021年02月18日)
改訂指示 反映履歴	
審査報告書 / 再審査報告書等	
緊急安全性情報	

PMDAホームページ上の最新の電子化された添付文書を表示

PMDAホームページ上の各種関連文書へのリンクを表示 (医療機器の例)

これまでどおり、PMDAの医療機器情報検索サイトからも閲覧いただけます。

→ <https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/kikiSearch/>

電子化された添付文書の紙媒体等が必要な場合は、下記へお問い合わせください。

・弊社ホームページ「メールでのお問い合わせ」：<https://leaders.co.jp/contact/>

### 参考

- 医薬品等の注意事項等情報の提供について <https://www.pmda.go.jp/files/000239067.pdf>
- 「医薬品等の注意事項等情報の提供について」に関する質疑応答集(Q & A)について <https://www.pmda.go.jp/files/000239068.pdf>
- 医薬品・医療機器等安全性情報No.381 <https://www.pmda.go.jp/files/000239746.pdf>
- 添付文書の電子化について <https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/0003.html>